

JMS 輸液セット（アイフューザー用）仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

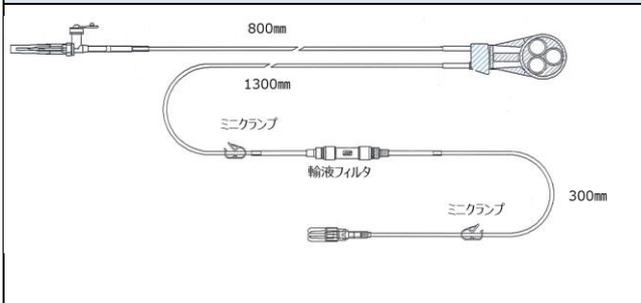
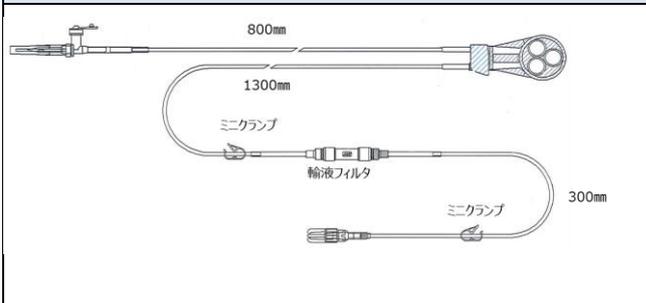
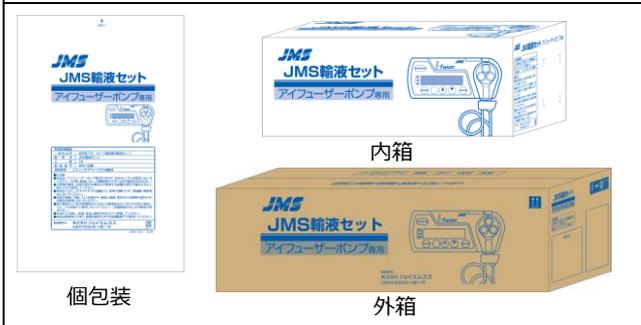
さて、この度、JMS 輸液セットにつきまして、下記の通り仕様変更のご案内をいたします。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

従来品	変更品
	
 <p>個包装 内箱 外箱</p>	 <p>個包装 内箱 外箱</p>
<p>変更内容</p>	<ul style="list-style-type: none"> 販売名をアイフューザー輸液セットに変更 個包装、内箱、外箱デザインを変更

従来品

販売名	品目コード	品番	品名	JANコード
JMS 輸液セット	016500200	JE-IFP02	IF 1I# IVF FL300	4987494201228

変更品

販売名	品目コード	品番	品名	JANコード
アイフューザー輸液セット	016800242	JE-IFP8CFCL	IF E800IVF FL300DEHPF	4987494307616

変更時期

在庫がなくなり次第、順次変更になります。

以上